

ANALIZA BIAŁEK



100016000

## Laboratorium Analizy

**Klient:** Slavic Labs  
**Numer zamówienia:** 100016000  
**Nazwa:** SLAVIC LABS N-ACETYL SEMAX  
**Ilość próbek:** 1 fiolka

**Numer partii:** 2026/06/26  
**Data przyjęcia:** 2026-07-08  
**Data rozpoczęcia:** 2026-07-13  
**Data zakończenia:** 2026-07-21

## Identyfikacja próbki

| Szukana substancja | Metoda pobrania próbki           | Postać                          |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| N-Acetyl Semax     | Próbka dostarczona przez klienta | Biały proszek w szklanej fiolce |

## Wyniki

| Substancja     | Nazwa próbki                    | Ilość   | Czystość |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|
| N-Acetyl Semax | SLAVIC LABS N-ACETYL SEMAX 50MG | 51,35mg | 99%      |

## Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3 µl na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H<sub>2</sub>O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 51,35mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

## Zdjęcie badanej próbki




## Hasło dostępu

W1N34D9K

**Analiza Białek sp. z o.o.**  
**KRS:** 0000966168  
**NIP:** 8992922970  
**REGON:** 521751875

**Siedziba i Laboratorium:**  
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław  
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**  
Specjalista ds. analiz i badań  
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100016000

## Chromatogram

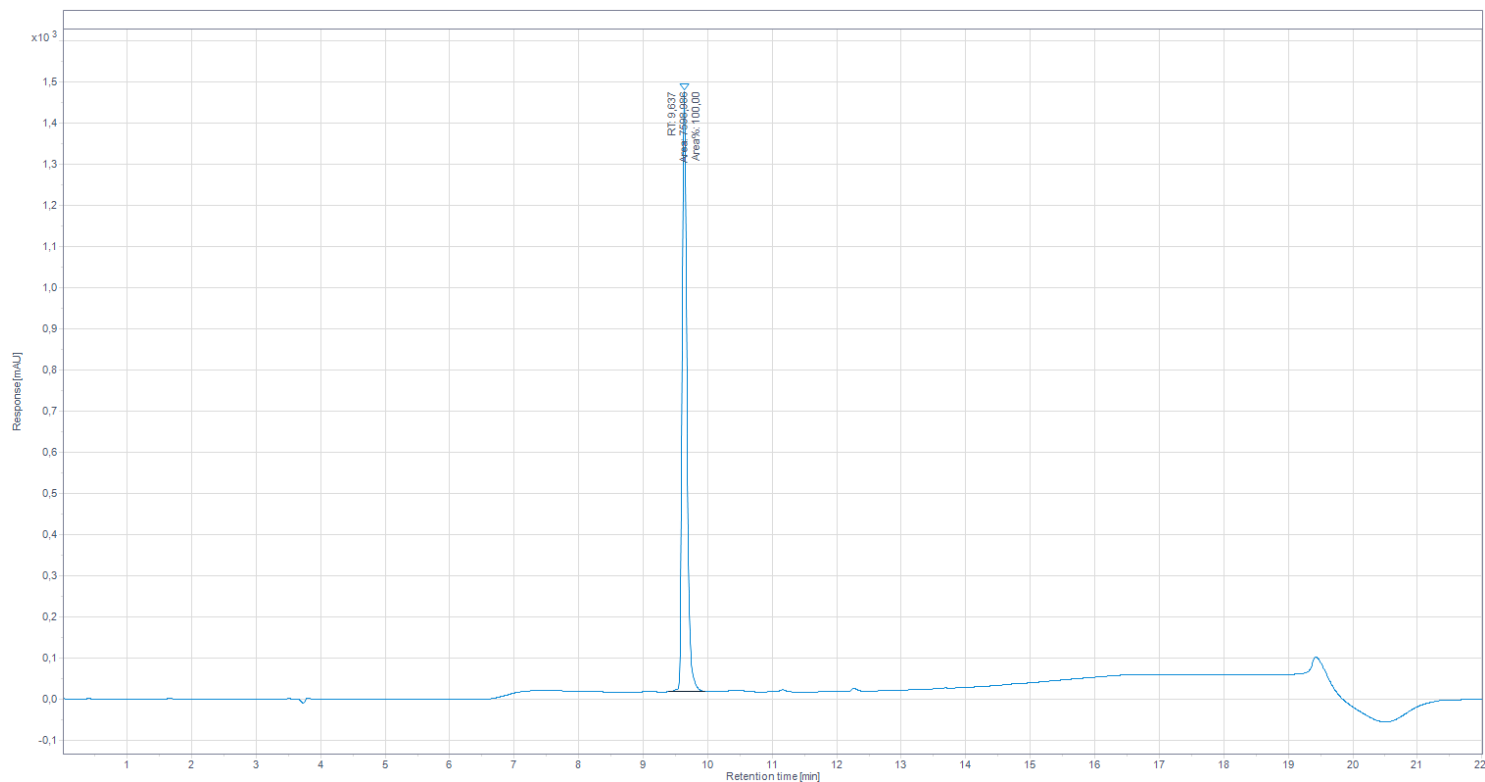

## Metoda

| Czas  | H2O + 0,1% TFA | ACN + 0,1% TFA |
|-------|----------------|----------------|
| 0min  | 95%            | 5%             |
| 2min  | 95%            | 5%             |
| 12min | 5%             | 95%            |
| 15min | 5%             | 95%            |

## Hasło dostępu

W1N34D9K

**Analiza Białek sp. z o.o.**

**KRS:** 0000966168

**NIP:** 8992922970

**REGON:** 521751875

**Siedziba i Laboratorium:**

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław  
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**

Specjalista ds. analiz i badań  
mgr Arkadiusz Zajac